

Radionuklidový generátor

Jelikož je potřeba radionuklidů v medicíně vysoká, jen stěží bychom vystačili s radionuklidy přírodními. Proto se musí radionuklidy připravovat uměle. Jeden ze způsobů výroby je pomocí **radionuklidového generátoru**.

Některé medicínsky využívané radionuklidy je možné připravovat v **radionuklidových generátorech**. Podmínkou je, že využívaný (dceřiný) radionuklid má několikrát kratší poločas rozpadu než mateřský. Poté může dojít k **rovnovážnému stavu**, kdy se rozpadne stejné množství dceřiného nuklidu, jaké vznikne z mateřského.

Při separaci dceřiného radionuklidu od mateřského se nejčastěji využívá *chromatografického principu*, kdy se dceřiný nuklid vymývá z kolony, ve které je mateřský nuklid fixován.

Stavba

Generátor se skládá z **kolony**, na které je fixován mateřský nuklid. Dceřiný se uvolňuje do promývacího roztoku. Kolona je zasazena do dostatečného stínění. „Chodbičky“, které vedou ke koloně, nesmí být přímé, aby nedošlo k úniku záření. Lahvička, ve které je radiofarmakum připravováno, je také stíněná.

Výhody a nevýhody

+ Relativně **malá cena** oproti urychlovačům a reaktorům, malé rozměry, snadná manipulace, dostupnost, různá skupenství radionuklidů, snadné zjištění aktivity.

- Nutnost stálého stínění, snižující se aktivita.

Techneciový generátor

Nejvyužívanější radionuklid – **^{99m}technecium** – je možné získávat z generátorů, což velmi usnadňuje přípravu radiofarmak, aniž by se výrazně snižovala jejich aktivita.

V koloně techneciového generátoru se nachází mateřský radionuklid **⁹⁹molybden**, který se vyrábí v urychlovačích. ⁹⁹Mo se s $T_{1/2}=63,8\text{h}$ mění β^- přeměnou na ⁹⁹Tc* s energií $E=140\text{keV}$ a poločasem rozpadu $T_{1/2}=6,0\text{h}$. Tento stav se označuje jako metastabilní stav jádra, což vyjadřuje krátkou životnost radioizotopu a zapisuje se ^{99m}Tc. Po odseparování ^{99m}Tc z generátoru, získáme zářič, který emituje fotony γ o výše uvedené energii $E=140\text{keV}$. Tyto fotony pak detekujeme scintilačními technikami.

Na každém generátoru je vyznačena aktivita vztahovaná k určitému datu.

Použití

Evakuovaná lahvička s připraveným **redukčním činidlem** (nejčastěji *chlorid cínatý*) a **látkou**, která má být označena, se připojí na výstupní ventil generátoru. Podtlakem se nasaje ze zásobníku eluční roztok a vymyje se technecium, které vzniklo rozpadem molybdenu.

Kryptonový generátor


Mezi generátory, které poskytují radionuklidy s velmi krátkým poločasem rozpadu, je nejrozšířenější generátor využívající izotopy ⁸¹Rubidia a ^{81m}Kryptonu, který slouží jako zdroj radioaktivního inertního plynu kryptonu ^{81m}Kr pro zobrazení distribuce plicní ventilace. ⁸¹Rb vázané na membráně generátoru se přeměňuje s poločasem $T_{1/2}=4,6\text{h}$ na ^{81m}Kr s poločasem $T_{1/2}=13\text{s}$. Z generátoru se přímo u vyšetřovaného proudem vzduchu vymývá plyn ^{81m}Kr. Aktivita v plicích se po vdechnutí ^{81m}Kr zobrazuje gamakamerou.

Galiový generátor

Germanium - galiový generátor poskytuje izotop galia ⁶⁸Ga s $T_{1/2}=68\text{ min}$ za rozpadu mateřského radionuklidu ⁶⁸Ge s poločasem rozpadu $T_{1/2}=271\text{dní}$.

Mateřský izotop ⁶⁸Ge se převážně vyrábí v protonových urychlovačích.

Odkazy

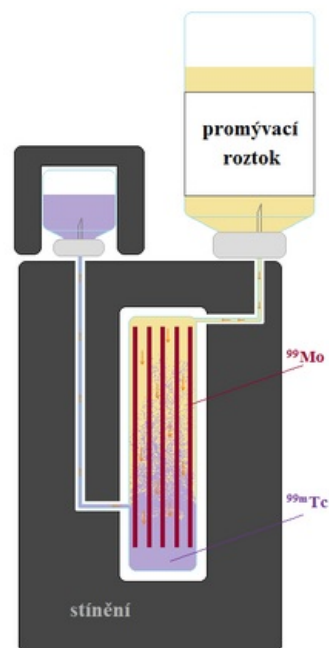

Související články

- Radiofarmaka
- Radionuklid

Použitá literatura

- KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL, et al. *Nukleární medicína*. 1. vydání. vydavatel, 2007. 185 s. ISBN 978-80-903584-9-2.