


Soubor:Spektrofotometr.jpg

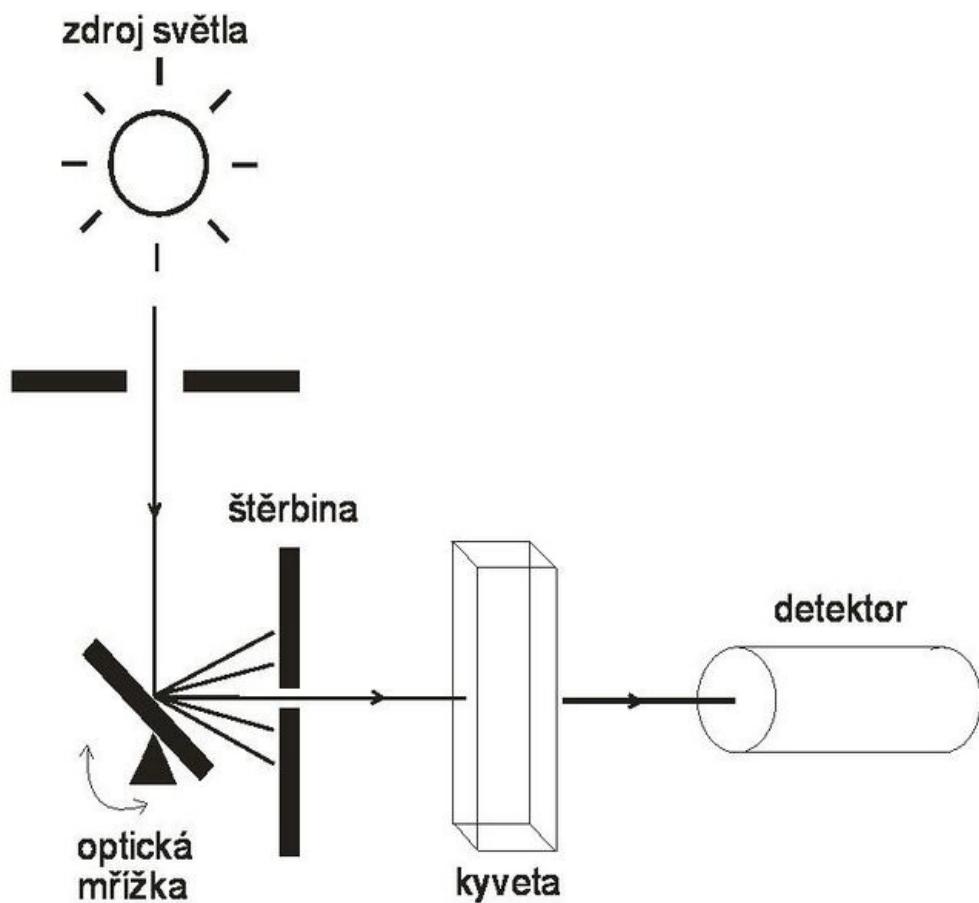


Size of this preview: 800 × 600 pixels.

Original file (960 × 720 pixels, file size: 36 KB, MIME type: image/jpeg)

Popis	Princip spektrofotometru
Zdroj	vlastní dílo
Datum	2007
Autor	MUDr. Martin Vejražka, PhD.
Licence	<p>Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 3.0 Česko (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/deed.cs)</p> <p>Dílo smíte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.▪ Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo částečně v jiných dílech.▪ Využívat komerčně. <p>Za těchto podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Uveďte původ — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). <p>Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons (https://creativecommons.org), které je pro vás závazné v plném znění. Existenci zde</p>

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

	Date/Time	Thumbnail	Dimensions	User	Comment
current	11:33, 2 May 2008		960 × 720 (36 KB)	Mvejr (talk contribs)	

You cannot overwrite this file.

File usage

The following file is a duplicate of this file (more details):

- Soubor:Spektrofotometr.jpg from Wikimedia Commons

The following 2 pages use this file:

- Spektrofotometr
- Spektrofotometrie

Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.