


Soubor:Strangulační ileus.JPG

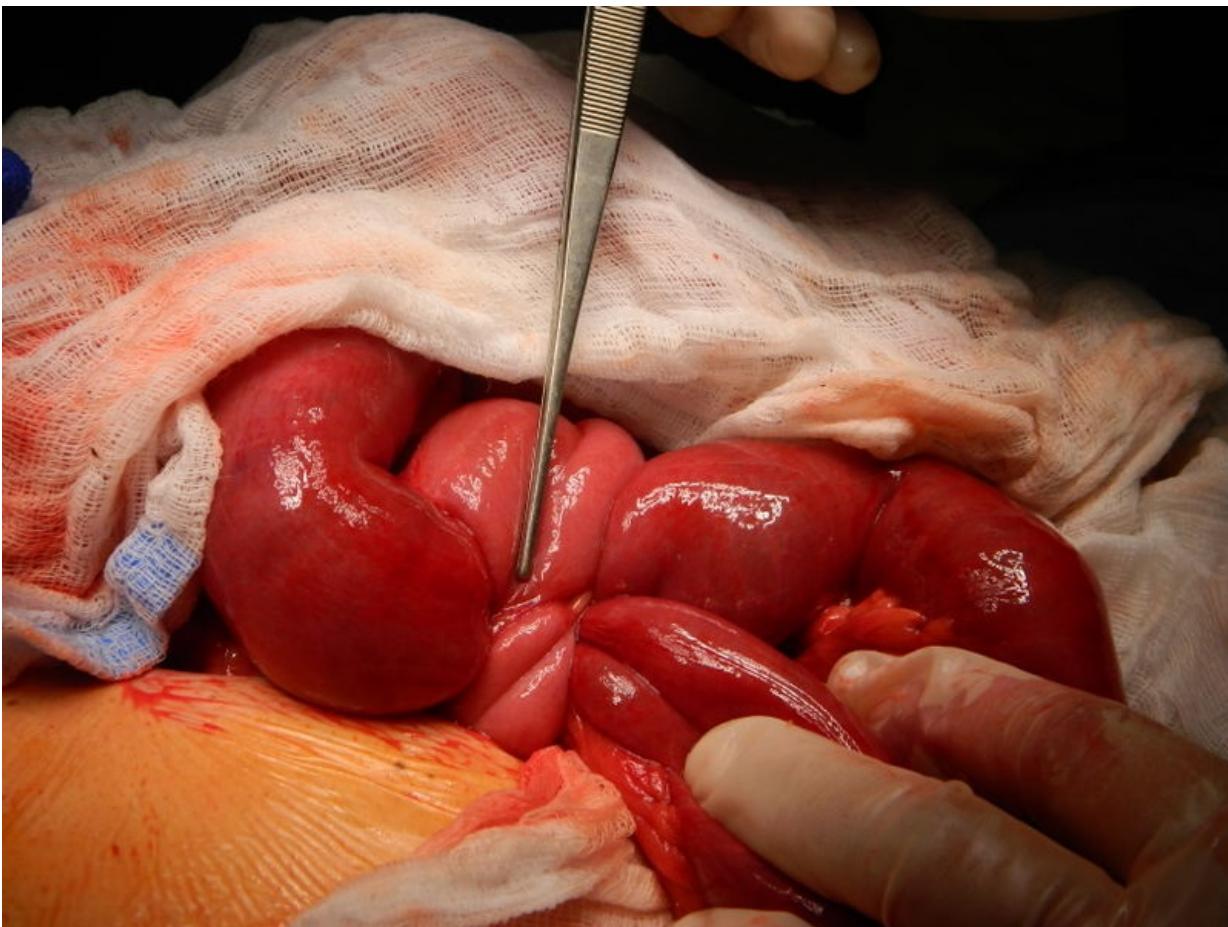

Size of this preview: 800 × 600 pixels.

Original file (3,264 × 2,448 pixels, file size: 1.67 MB, MIME type: image/jpeg)

Popis	Strangulace střeva a následní ileus
Zdroj	vlastní dílo
Datum	2016-10-03
Autor	JBart
Licence	<p>Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 3.0 Česko (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/deed.cs)</p> <p>Dílo smíte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.▪ Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo částečně v jiných dílech.▪ Využívat komerčně. <p>Za těchto podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Uveďte původ — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). <p>Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons (https://creativecommons.org), které je pro vás závazné v plném znění. Existenci zde</p>

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

	Date/Time	Thumbnail	Dimensions	User	Comment
current	19:35, 3 October 2016		3,264 x 2,448 (1.67 MB)	JBart (talk contribs)	{{Soubor popis = Strangulace střeva a následní ileus zdroj = {{vlastní dílo}} datum = 2016-10-03 autor = Uživatel:JBart licence = {{cc by 3.0 cz}} }} Kategorie:Chirurgie Kategorie:Obrázky

You cannot overwrite this file.

File usage

The following page uses this file:

- Ileus

Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.

Camera manufacturer	NIKON
Camera model	COOLPIX L120
Exposure time	1/200 sec (0.005)
F Number	f/11.4
ISO speed rating	80
Date and time of data generation	19:30, 17 October 2015
Lens focal length	12.6 mm